

## Philips Lumify 隐私声明

本隐私声明上次更新日期为 2023 年 9 月 1 日

Philips Lumify 移动应用程序（以下简称“应用程序”）在与 Philips Lumify 探头（以下简称“设备”）搭配并由受过培训的医疗专业人员使用时，可将智能设备转变为移动超声解决方案。本隐私声明旨在帮助您在使用我们的服务时了解隐私惯例，包括我们收集哪些数据、收集这些数据的原因、对其进行的处理以及您的个人权利。

本隐私声明适用于由设备和/或应用程序收集或处理的数据，该设备和/或应用程序受 Philips Ultrasound, Inc.或其任何附属公司或子公司（以下简称“Philips”或“我们”）的控制或在其控制范围内。

**请注意：**出于对用户隐私的保护，我们无意且也不会通过该应用程序收集您或任何医疗专业人员、患者的个人信息。为了确保该等信息不被收集，请您阅读并按照附件《Lumify 开机界面指示》的说明，填写与个人信息无关的示意性信息。

### 设备数据

我们收集与设备有关的数据（“设备数据”）。此类设备数据包括：Lumify 应用程序软件版本；探头序列号和型号；安装应用程序（用于与探头搭配使用）的智能设备型号名称和设备标识，该设备上运行的操作系统版本；以及 iOS Lumify 电源模块的序列号和固件版本。通过接受本隐私声明，您确认我们可以收集、保存和使用设备数据。

收集设备数据的主要原因在于一旦发生召回，所收集的设备数据将用来查找可能存在问题的配置。

### Cookie

我们在应用程序中不使用 Cookie、标签或类似技术。

### 许可权限

该应用程序可能会请求您授予权限，以便访问您的手机或传感器（例如摄像头、Wi-Fi 或蓝牙）。

在一些情况下，许可权限是移动设备操作系统的技术先决条件。在这种情况下，应用程序可能会征求您的许可，以访问此类传感器或数据。我们不收集、保存和使用相关数据。

### 与第三方共享

Philips 有时会将某项业务或某项业务的一部分出售给其他公司。此类转移所有权的情况可能包括将与该业务有直接关系的数据转移给购买该业务的公司。在合并、收购、重组或出售资产时，或者执行法律或其他情况下，Philips 可以将我们在隐私声明中的所有权利和义务自由转让给我们的任何附属公司，并且我们可能会将相关数据转移到我们的任何附属公司、后续实体或新所有者。

### 跨境转移

设备数据可能会在我们拥有设施或与服务提供商合作的任何国家/地区进行存储和处理；使用服务即表示您同意将设备数据转移（如果有）到居住国以外的国家/地区，这些地区所设立的数据保护规则可能与您所在国家/地区有所不同。在某些情况下，上述其他国家/地区的法院、执法机构、监管机构或安全机构可能有权访问设备数据。

### **保留设备数据的时长**

根据收集数据的目的，我们将在需要或允许的时间内保留设备数据。我们用于确定保留期限的标准包括：(i)您使用应用程序和服务的时长；(ii)我们是否需要承担法律义务；或(iii)根据我们的法律立场（例如适用的时效法规、诉讼或监管调查），是否宜保留数据。

### **本隐私声明变更**

我们的服务可能会不时更改，恕不另行通知。因此，我们保留不定期修改或更新本隐私声明内容的权利。当我们更新本隐私声明时，我们也将更新位于本隐私声明顶部的日期。

建议您定期查阅本隐私声明的最新版本。

新版隐私声明一经发布立即生效。如果您不同意修订后的声明，请更改您的首选项或考虑停止使用我们的服务。如果您在这些更改生效后继续访问或使用我们的服务，即表示您确认已知悉并同意修订后的隐私声明。

### **联系我们**

如果对本隐私声明有任何疑问，请通过[联系表单](#)或以下地址与我们的数据保护官联系。

Philips  
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands.

## 附件：Lumify 开机界面指示

致用户：

您好！

欢迎您选购并使用飞利浦 Lumify 产品。针对飞利浦 Lumify 产品的注册使用操作，进行以下说明。当您将探头与移动设备（平板或手机）连接之后，您会看到以下界面：

10:09 26%

← PHILIPS

### 联系信息

请提供机构联系信息以接收产品通知。

机构 \*

联系人

邮编/邮政编码 \* 国家/地区 \*

中国

机构/联系电子邮件地址 \*

随时了解新产品信息。  
要了解更多信息，请查看我们的[隐私声明](#)。


清除表单 提交信息

请注意，出于对用户隐私的保护，我们无意且也不会通过该应用程序收集您或任何医疗专业人员、患者的个人信息。因此，请您按照以下指示在该界面中填入以下示意性信息，并点击“提交信息”：

- 机构\*: Lumify 中国用户;
- 联系人: Lumify 中国;
- 邮编\*: 2000XX
- 电子邮件\*: [Lumify.china@philips.com](mailto:Lumify.china@philips.com);
- 无需勾选“随时了解新产品信息”

注意：带\*为必填项,联系人栏可留空；您也可以输入其他非真实的信息，例如机构可以是任意名称，邮编和电子邮箱可以为虚拟信息。

填写后的界面如下：

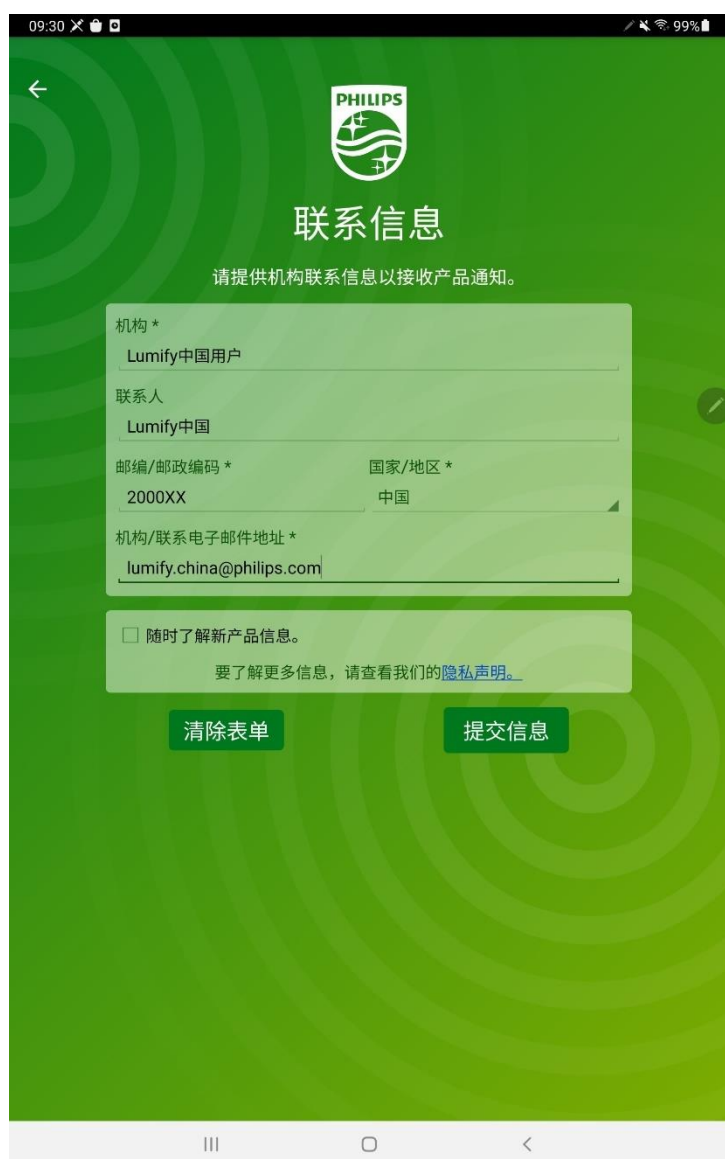

09:30 99%

← PHILIPS

## 联系信息

请提供机构联系信息以接收产品通知。

机构 \*  
Lumify中国用户

联系人  
Lumify中国

邮编/邮政编码 \* 国家/地区 \*  
2000XX 中国

机构/联系电子邮件地址 \*  
lumify.china@philips.com

随时了解新产品信息。  
要了解更多信息，请查看我们的[隐私声明](#)。

清除表单 提交信息

请知悉，您按照如上指示填写信息，并不会对您使用产品产生任何实质影响。飞利浦会及时为您提供产品相关的更新和通知。

产品具体使用方式请参考 Lumify 用户使用手册。

如需售后服务或协助，请致电飞利浦客户响应中心，电话：800-810-0038 或 400-810-0038。